

## “血糖试纸”院内招标报名公告

根据工作需要，桂林市中医医院拟对设备科申请的“血糖试纸”项目进行院内招标，欢迎符合条件的供应商前来报名，现将本次招标的有关事项公告如下：

- 1、项目编号：GLSZYYY202320
  - 2、项目名称：血糖试纸
  - 3、资金来源：自筹资金
  - 4、资质条件要求：①满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；②国内注册(依法在工商行政管理部门登记注册)，具备法人资格的供应商；③具备相关项目经营范围的单位。供应商须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规。
  - 5、资格条件特别说明：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。②对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动。
  - 6、报名时间：2023年6月12日-6月19日（上午8：00-12：00，下午15：00-18：00 双休日和法定节假日除外），逾期不接收报名。
  - 7、会议时间：另行通知（报名商家应密切留意本网站最新会议时间公告通知）。
  - 8、报名地点：桂林市临桂路2号，桂林市中医医院1号楼7楼招标办公室。请网上报名，报名表见附件（报名邮箱 [glzyyzbb@163.com](mailto:glzyyzbb@163.com)）。
- （注：报名后如不能如期参会，请务必在会议前一天中午12点前发邮件至报名邮箱。否则视为不诚信供应商，列入医院黑名单。）
- 9、联系人及电话：张老师 0773-2813444。

桂林市中医医院招标办公室

2023年6月12日

**附件 1. 桂林市中医医院院内招标会报名表**

报名单位全称			
法定代表人			
公司详细地址:			
联系人:		联系方式:	
<b>参会项目（参会商家必填）</b>			
序号	参会项目名称	品牌型号	备注
1			
2			
3			

报名指定邮箱：[glzyyzbb@163.com](mailto:glzyyzbb@163.com)；1. 请务必在邮箱主题栏上注明以下报名信息：[项目编号+项目名称（多项目时需注明对应报价表中的序号）+公司名称](#)；2. 报名表需发电子 word 文档，word 文档的文件名需注明：[项目编号+项目名称+公司名称](#)；3. **不注明相关报名信息、报名表为图片或 PDF 文档的均视为报名不成功。**

1. 参会商家把填写完整报名表（**word 文档**）、参会项目相关资质证明（**PDF 文档**）【三证合一营业执照复印件（盖鲜章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（盖鲜章，授权委托书须提供）、授权委托代理人身份证复印件、委托人社保证明（原件备查，授权委托书须提供）及供应商参会项目相关资质证明一起合成 **PDF 文档**】上传到指定邮箱，即完成商家参会报名手续。

2. 商家完成报名手续后即准备参会文件，参会文件包含（**以下内容很重要，请仔细阅读并按顺序装订成册**）：

- ①报价表；
- ②技术参数偏离表、配置列表、服务方案、产品彩页/说明书/项目效果图等；
- ③商家三证合一的营业执照、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（授权委托书须提供）、授权委托代理人身份证复印件（授权委托书须提供）、委托人社保证明（授权委托书须提供）；
- ④企业生产、经营许可证、产品注册证及供应商相关资质；
- ⑤提供 2020 年以来与本次投标产品相同品牌型号/项目的用户清单、三级甲等医院采购合同书复印件至少 2 份（需加盖公章）；
- ⑥售后服务、产品保修期、公司业绩、联系人及电话等相关资料。参会资料要求印刷清晰、密封并加盖公司公章，正本 1 份，副本 8 份，正本需装订整齐成册要


有封面(装订样式见附后)。

⑦参会人员要熟悉业务，能详细介绍项目内容、产品性能等相关内容。

3. 所提交给医院的投标资料，恕不退回。报名后如不能如期参会，请务必在会议前一天中午 12 点前发邮件至报名邮箱；否则视为不诚信供应商，列入医院黑名单。

**备注：参会文件所提供的证照及相关证明材料必须真实有效，一经发现造假，将取消本次参会资格并追究相关法律责任。参会文件正本所有证照复印件需加盖公章。**

参会资料装订样式：正本需装订成册、副本装订样式。

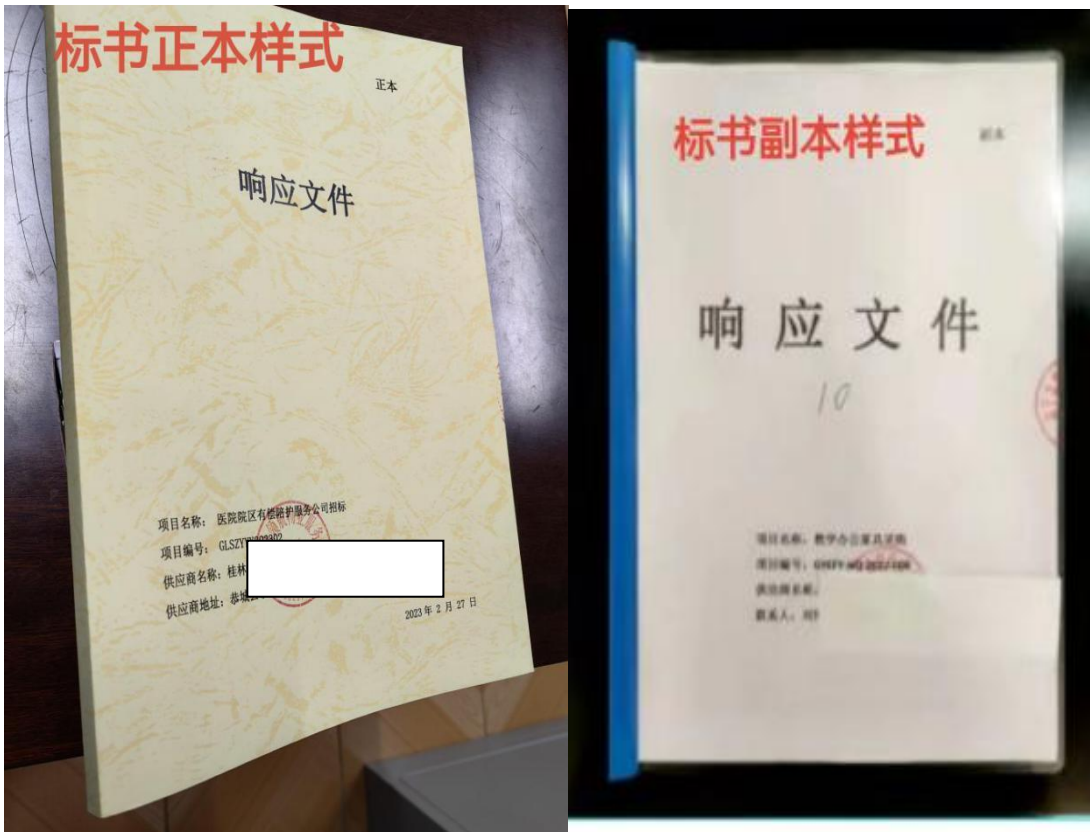

## 附件 2. 项目报价表

单位：元

供应商（盖章）：						
联系人：						
序号	产品名称	单位	生产厂家	单价	质保期限	备注
1						
2						
	合计					

### 附件 3. 项目招标需求

#### 1、血糖试纸：

1.1、检测原理：FAD 葡萄糖糖脱氢酶/干化学法；

★1.2、调码技术：免调码/全自动调码；

1.3、检测种类：毛细血管全血、静脉全血；

1.4、检测时间：≤5 秒；

1.5、检测范围：0.6—33.3mmol/L；

★1.6、红细胞压积范围：0-70%；

★1.7、二次加样：支持二次加样；

1.8、吸血量：≤0.6 微升；

1.9、试纸效期：≥24 个月，且不受开瓶影响；

1.10、检测部位：指尖、手掌、前臂；

1.11、检测温度：5—44℃；

1.12、检测湿度：10—93%；

1.13、抗干扰能力：不受麦芽糖、半乳糖影响；

1.14、产品执行标准：ISO15197：2013；

1.15、准确度要求：99%的结果落在 YSI 实验室参考值±10%的误差范围内；

★1.16、试纸价格不高于 1.68 元/片。

#### 2、血糖信息管理系统：

2.1 血糖信息化管理系统生产厂家具备软件著作资格，通过第二级信息系统安全保护；

2.2 可以根据医院要求，进行软件定制化开发；

2.3 血糖信息化管理系统与临床智能血糖仪需实现无缝对接，数据可以通过 WIFI 上传；

2.4 血糖信息化管理系统能够与医院 HIS、LIS、EMR 及集成平台等系统实现连接；

2.5 自动分析血糖数据，形成每日、多日及 7 个时间段分析图；

2.6 可以进行低血糖、高血糖等大事件标记，并显示大事件对血糖影响的曲线变化图；

2.7 分析的血糖报告模版可以自定义；

2.8 数据统计：多种维度分析患者血糖，支持血糖报告/血糖记录/趋势图打印和下载；

2.9 可统计科室耗材使用量与医护人员工作量；

2.10 预警管理：设定科室和个人血糖管理目标值，可实时报警，及时干预；

3. 质控服务：免费按需提供质控液，并配合做好厂家质控。

附件 5：技术参数偏离表

供应商：

响应产品品牌/型号：

项目	医院设备需求 (条目式)	参加招标设备 参数	偏离情况 (无偏离/正偏离/ 负偏离)	其他
设备需求	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
配置清单	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
培训	1.			
	2.			